


آزمایش Fe

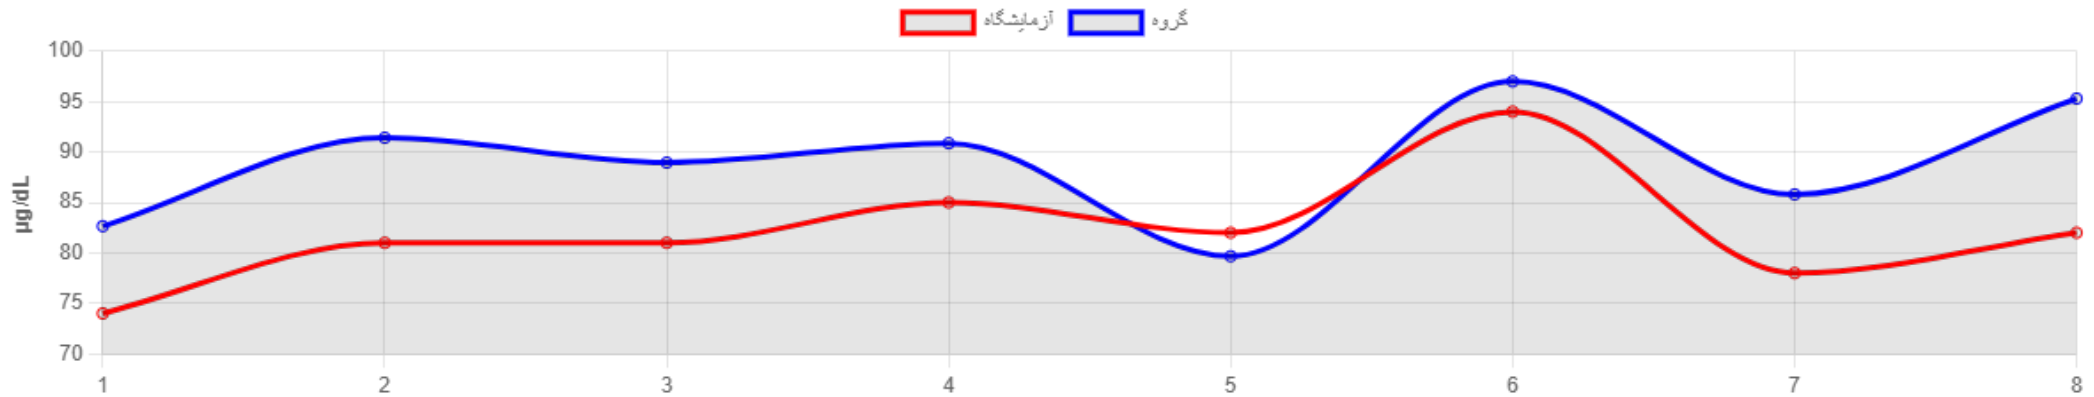

دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	10	74.00	82.65	0.93	10.72	-0.98	-10.47	-2.64 تا -18.30
2	1403/08/13	11	81.00	91.42	0.00	10.98	-1.04	-11.40	-4.02 تا -18.77
3	1403/08/20	11	81.00	88.95	0.00	7.62	-1.17	-8.94	-3.94 تا -13.95
4	1403/08/27	12	85.00	90.88	0.00	6.05	-1.07	-6.46	-2.62 تا -10.31
5	1403/09/04	8	82.00	79.67	0.00	4.59	0.64	2.92	6.53 تا -0.70
6	1403/09/11	9	94.00	97.00	0.00	3.26	-0.95	-3.09	-0.67 تا -5.51

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-4.41 تا -13.77	-9.09	-1.23	7.36	0.00	85.80	78.00	12	1403/09/18	7
-6.54 تا -21.37	-13.96	-1.45	9.62	0.00	95.30	82.00	8	1403/09/25	8
10.32 تا -25.45	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :